

デューク-ター-硬心試験器


2006準拠ゴム硬さ計シリーズ



	Peak	Nsec
ハイキン)	53.8	49.0
ハンサ)	0.0	00.5
CV)	02.0	0.0

特 長

- 定荷重型自動測定により個人誤差の無い再現性の高い測定データが得られます。
- 測定値の合否判定がH.Lのリミット値入力により可能。
- 5回測定モード選択時はJISに準拠したデータが自動的に得られます。
- 測定データは見易い大型LEDに表示され、標準で外部プリンターに出力可能。
- RS-232Cが標準でサポートされPCへの測定。データの転送により、PCのデータ処理ソフトが有効活用できる。
- オプションのセンサー交換でタイプD,タイプEデュロメーターも測定可能。
- 小型・軽量で場所を選びません。
- センサー降下方式はJIS対応の3.2mm/s。

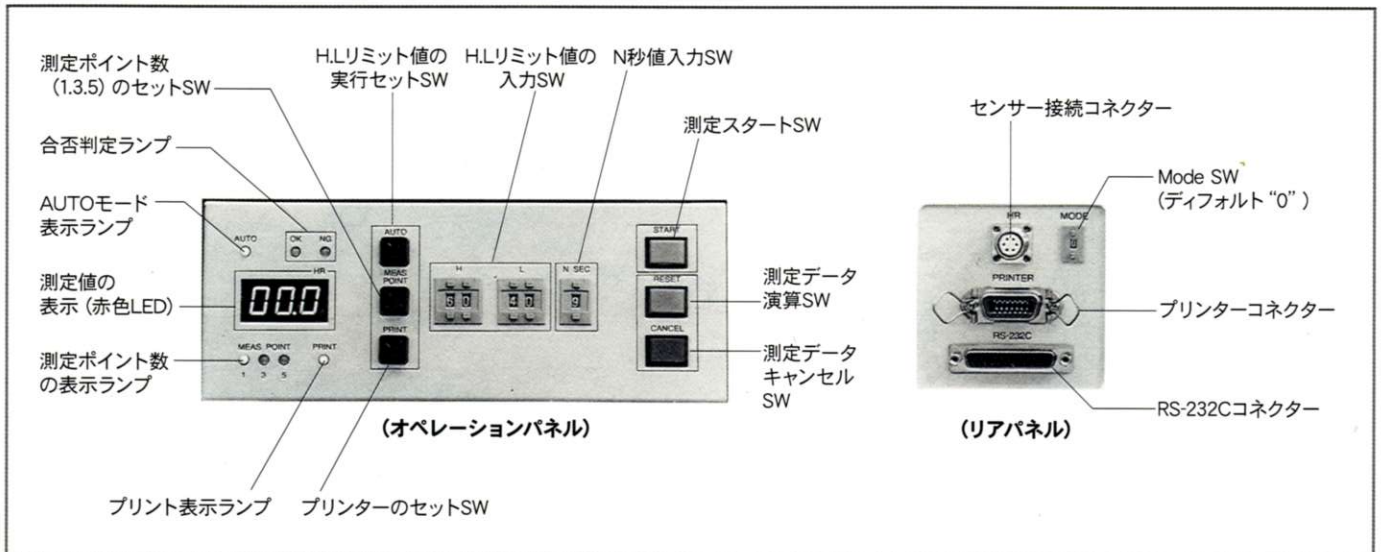

仕 様			
測 定 方 式	タイプAデュロメーター	試料台から加圧面までの距離	25mm (調整可)
センサー加圧面	18mmφ、押針孔3mmφ	試料台寸法	185(W)×100(D) mm
定 荷 重 量	1.0kgf 及び 5.0kgf	外 部 出 力	セントロニクス(プリンター用)
測 定 範 囲	00.0~100度	"	RS-232C
精 度	±1度	外 形 寸 法	約350(W)×440(D)×400(H)mm レベル含まず
分 解 能	0.2度	重 量	約18.0Kg
センサー降下方式	A Cモーター制御	電 源	AC100V 50/60Hz
定 荷 重 方 式	センサー及びセンサーホルダーの自重荷重式	外部プリンター (推奨品)	SD1-31PJ 感熱式、紙幅80mm AC100~240V 50/60Hz
センサー降下速度	3.2mm/s・10mm/s 切替式		

製造販売元

Excel **エクスセル株式会社**

<http://www.excelinc.co.jp>

■本 社

〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合3-4-15
TEL 048-857-3541 FAX 048-857-3530

■HEAD OFFICE

3-4-15, KAMIOCHIAI, CHUO-KU, SAITAMA-CITY,
SAITAMA, JAPAN

■大阪営業所

〒562-0041 大阪府箕面市桜5-20-22 コスモス102号
TEL 072-724-3777 FAX 072-724-6685

販売店